FOLHA STERI-PAK™ LF

Folhas de Teste Bowie-Dick

com Tecnologia em Tinta Azul-para-Preto

Código: BD 110

- Fórmula superior da tinta auxilia na interpretação
  Tinta azul permanece se houver vazamento de ar
- Tinta com desenho contínuo do centro para a borda
  Mais fácil de confirmar vazamento de ar
- Mudança de cor permanente
  Pode ser usado como arquivo permanente quando armazenado fora do alcance da luz
- Livre de chumbo e metais pesados tóxicos
- Mudança completa de cor após 3.5 minutos a 134°C
- ISO 11140-1, classe 2
- ISO 11140-3
- Aprovado pelo FDA

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS	
ITEM #	**EMBALAGEM**
BD 110	CAIXA COM 100 FOLHAS

SteriTec

Importador para o Brasil
Stericontrol
"Os nossos clientes sabem a diferença!"
sac@stericontrol.com.br

Imagens meramente ilustrativas.

FOLHA STERI-PAK LF
Folha de Dados Técnicos

Stericontrol
"Os nossos clientes sabem a diferença!"

Descrição:

O indicador Bowie-Dick ***BD-110 Steri-Pak LF*** em folhas medindo 21,59cm X 27,94cm, foi desenvolvido para trazer aos seus usuários um produto de qualidade para monitorar, diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. O teste foi projetado para uso único e individual, conforme as normas ISO 11.140-3 e AAMI-ST66, com a grande vantagem de proporcionar ao usuário uma leitura de fácil interpretação de resultados, aumentando assim a precisão do teste e a qualidade final do serviço.

O teste Bowie-Dick ***BD-110 Steri-Pak LF*** folha é colocado no esterilizador no local mais difícil de atingir as condições de esterilização, (normalmente acima do dreno, perto da porta) em um ciclo de 3.5 a 4 minutos a 134°C.

A retenção de ar no pacote pode ser decorrente de falhas, que vão desde problemas com o equipamento (guarnições, válvulas etc...) ou até mesmo o empacotamento, quando este não atende o que especifica a norma para fabricação do teste. A norma ISO 11.140 diz que o indicador Bowie & Dick deve demonstrar uma mudança uniforme de cor após a exposição ao vapor saturado a 134°C por 3.5 a 4 minutos.

A tinta indicativa da folha de teste foi quimicamente formulada para reagir à presença do vapor saturado, sendo extremamente sensível à presença de ar, não contem metais pesados em sua formulação e sua folha é plastificada proporcionando maior sensibilidade ao teste. Uma correta exposição assegura a uniformidade da cor após a suficiente eliminação de ar do pacote.

Instruções de uso

1. Faça um ciclo de pré-aquecimento, antes do teste, toda vez que o equipamento ficar parado mais que 60 minutos, pois o equipamento frio tende a acumular condensado nas tubulações de alimentação de vapor e na câmara externa, e isso prejudicar a performance do equipamento, podendo causar uma falha no teste.
2. É aconselhável a realização do teste antes do início de cada jornada de trabalho.
3. Preencha os campos de identificação contidos na parte inferior da folha de teste.
4. Coloque a folha no centro do pacote teste, não maior que 25cm x 30cm x 25cm a 28cm (pacote padrão).
5. Coloque somente o pacote teste na autoclave, de preferência sobre o dreno da câmara. O teste deve ser realizado com ciclo de exposição de 3.5 a 4 min. à 134º C, ou conforme especificado na bula do produto.
6. Após o término do ciclo, retire o pacote teste do equipamento e faça a leitura do resultado.

Dimensões do Pacote:

A folha de Teste foi projetada para uso em um pacote com dimensões de 25cm de largura por 30cm de comprimento e altura variando entre 25cm e 28cm, devendo ser confeccionado em toalhas cirúrgicas, lavadas recentemente e sem passar. O teste deverá ser colocado no meio das toalhas e o pacote embalado com campo cirúrgico duplo, 100% algodão, e não pesar mais que 4kg, como definido pela Norma ISO 11.140.

Leitura da coloração da folha de Teste

Ao retirar o teste do pacote, verifique:

- O ideal é uma coloração preta e uniforme em toda a superfície da folha.
- São falhas no processo, sinais ou manchas que caracterizem que a mudança não foi uniforme ou qualquer outra cor que não a preto uniforme.
- Excesso de tempo e umidade, vapor superaquecido, também podem ser demonstrados, através da apresentação da cor cinza ou manchas de umidade.
- A ocorrência seguida de falhas no teste Bowie & Dick, indica a necessidade de manutenção do equipamento.

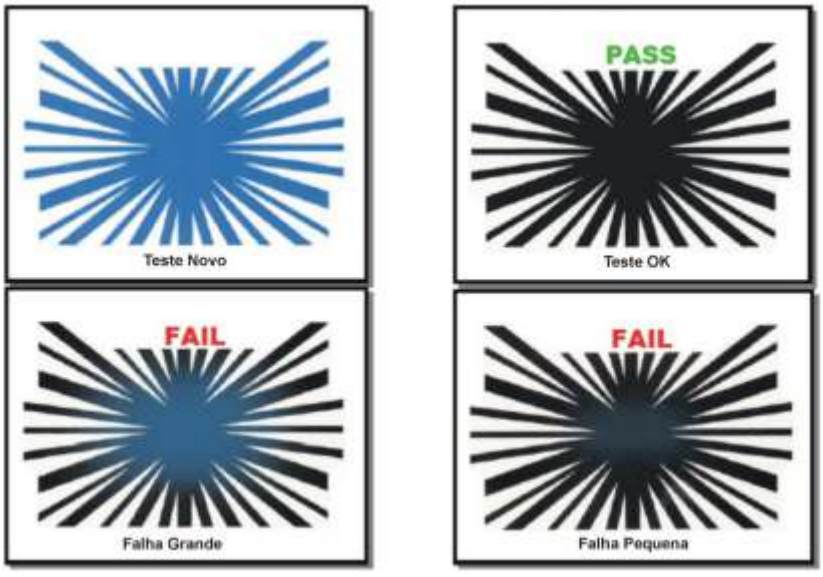

Características físicas:

Dimensões: 21,59cm X 27,94cm

Limitações ambientais:

Armazenamento, validade e número do lote estão impressos em cada embalagem.

Classificações de normas:

AAMI ST66
EN ISO 11.140-1 e ISO 11.140-3, Classe 2

Registro no MS. *Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme RDC 185/2001 - ANVISA*

Form No.: FTP-073 Rev.: G

IMPORTADOR OFICIAL PARA O BRASIL:
Stericontrol Comercial Hospitalar Ltda.
Tel/fax: (43) 3348-1516 - sac@stericontrol.com.br
www.stericontrol.com.br

DISTRIBUIDOR LOCAL: